

お客様各位

ウリエース 製品・包装デザイン等 変更のご案内

2021 年 2 月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ウリエースにつきまして、下記のとおり、製品本体および包装デザイン・表示内容を変更いたしますのでご案内申し上げます。

移行過程において変更前後の製品が混在することがございますが、ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 変更内容

①包装サイズを大缶Lに統一します。これに伴い一部品種で包装サイズ、スティック長が変更になります。

対象品種：Kc(コード番号：UA-L03K)

Tb(コード番号：UA-L02T)


Db(コード番号：UA-L02D)

	変更前	変更後
缶サイズ	最外径 φ50mm × 高さ (H) 109mm	最外径 φ50mm × 高さ (H) 137mm
単位箱	幅 (W) 53mm × 奥行き (D) 53mm × 高さ (H) 111mm	幅 (W) 53mm × 奥行き (D) 53mm × 高さ (H) 139mm
中間箱	幅 (W) 273mm × 奥行き (D) 109mm × 高さ (H) 115mm	幅 (W) 273mm × 奥行き (D) 109mm × 高さ (H) 143mm
出荷箱	幅 (W) 563mm × 奥行き (D) 285mm × 高さ (H) 130mm	幅 (W) 563mm × 奥行き (D) 285mm × 高さ (H) 160mm
スティック長	92mm	120mm


②視認性および刻印の耐久性向上のため、缶ラベルおよび単位箱に記載されている製造番号、使用期限の印字を変更いたします。

例) 単位箱

変更前

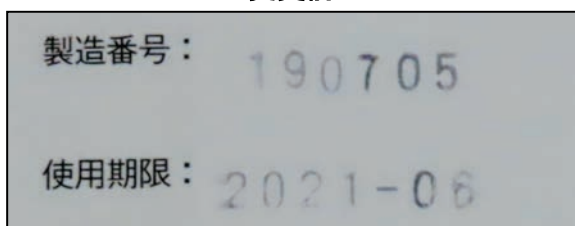

変更後

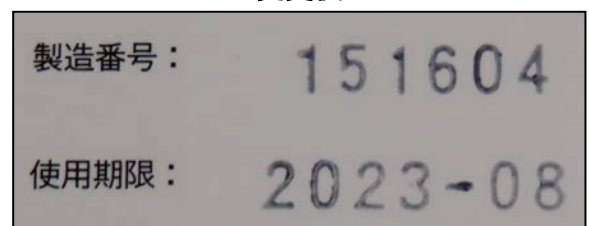

※変更後の製造番号、使用期限の表示はダミーです。

次頁もご覧ください

③包装資材のデザイン、表示内容および順番を変更いたします。

例) ウリエース-MN

<缶ラベル>

変更前



変更後



<単位箱>

変更前



変更後




<中間箱>

品種表示を廃止します。各品種は中間箱ラベルをご確認ください。

変更前




変更後

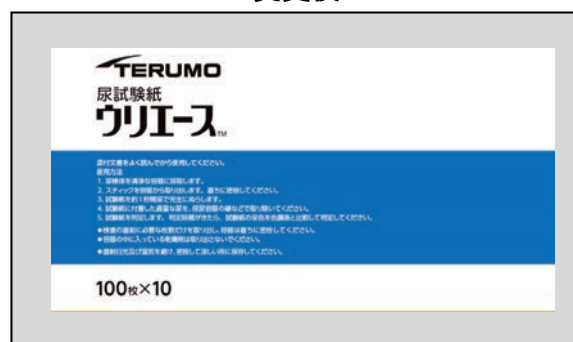


<封止テープ>

変更前

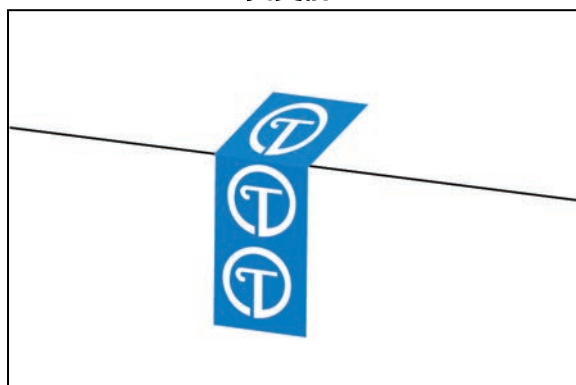

変更後

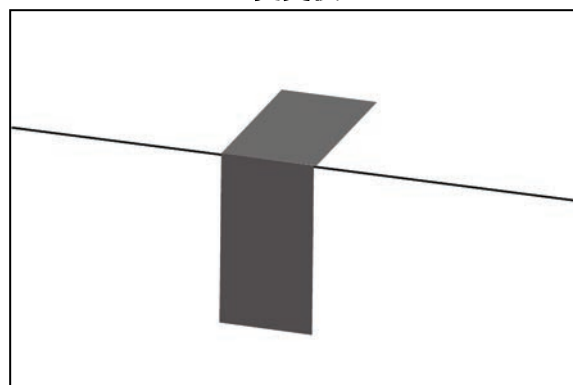

<出荷箱>

変更前



変更後



- **変更開始時期** 2021 年 3 月下旬より順次
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

■ **変更対象品種**

品 種	コード番号	包装単位（枚）	統一商品コード	変更内容		
				① 包装サイズ 変更	② 印字変更	③ デザイン 変更
ウリエース-MN	UA-L08M	100	350280398	—	●	●
ウリエース-M	UA-L07M	100	350280411	—	●	●
ウリエース-Tf	UA-L06T	100	350280435	—	●	●
ウリエース-Te	UA-L05T	100	350280459	—	●	●
	UA-R05T	1000 集積包装タイプ (100 枚×10 缶)	350282675	—	●	●
ウリエース-Kc	UA-L03K	100	350280275	●	●	●
ウリエース-Tb	UA-L02T	100	350280336	●	●	●
ウリエース-Db	UA-L02D	100	350280350	●	●	●

■ **本製品のお問合せ先**

テルモ・コールセンター：0120-12-8195（9:00～17:45 土・日・祝日を除く）

または担当 MR までお問合せください。

販売名：ウリエース 体外診断用医薬品